

# Cleanup

oclusor antimicrobiano

## “ Dispositivo de proteção e desinfecção passiva para conectores sem agulha ”

Sem uma correta desinfecção, os conectores sem agulhas são possíveis focos de contaminação microbiana intraluminal.<sup>1</sup>

**1'** Desinfeta em 1 minuto e protege por até 7 dias, sempre que não seja removido.




Garante segurança e eficácia no cumprimento do protocolo de desinfecção.




Contribui com a diminuição das taxas de infecção da corrente sanguínea.<sup>2</sup>



Desenho Luer lock, compatível com todos os conectores sem agulha do mercado.<sup>3</sup>

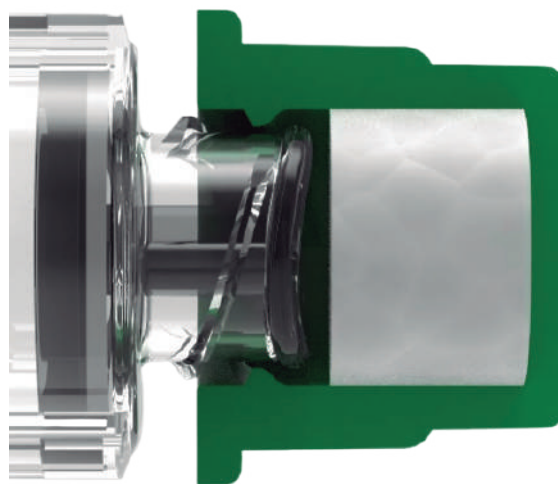

**Apresentação em curos perfurados com orifício superior, assegura ao profissional um fácil acesso ao dispositivo.**

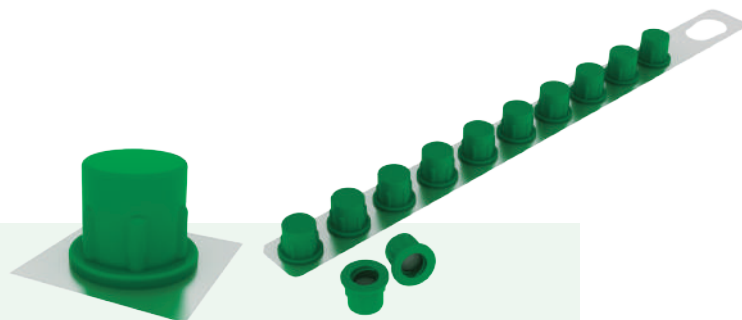

1,2.Gorski L., Hadaway L., Hagle ME., McGoldrick M., Orr M., y Daellman D. (2016). Standar of practice. Journal of Infusion Nursing; 34(1S): S73, S74  
3. ISO 80369-7