




“ É o sistema de administração para nutrição enteral segura com conexão ENfit ”



Os sistemas de conexão constituem um **fator determinante na segurança do paciente.**



Orientação invertida dos conectores macho/fêmea com respeito aos sistemas de administração intravenosa.

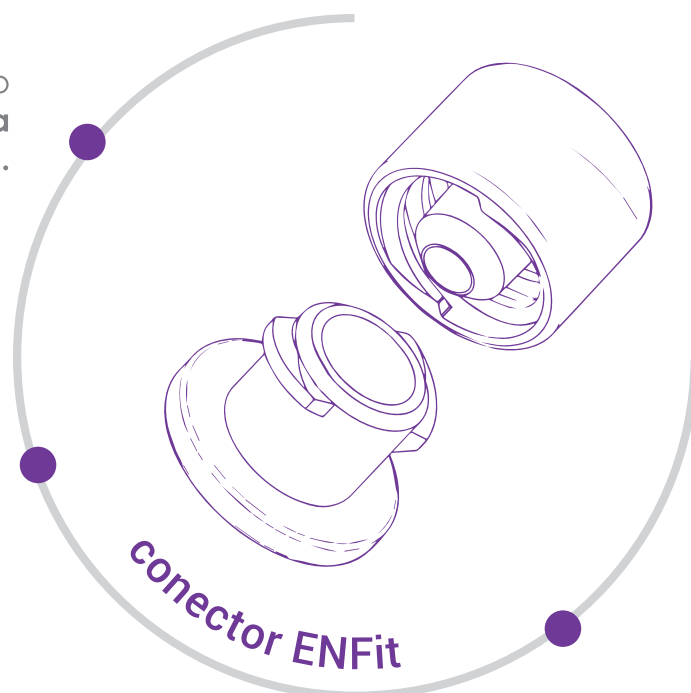

Incompatibilidade por desenho

A diferença de diâmetro e ângulos das roscas impede a conexão do sistema Luer Lock (ISSO 80369-7 ex 594) utilizado em tubos, seringas e cateteres para acesso vascular.

Utiliza-se o calor como principal atributo de identificação da função. **VIOLETA = ENTERAL**

Escaneie o QR code e conheça o catálogo completo

